



零件承认书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称：001

增益型号：ZET127S-600M

规格描述：T12.7*7.92*4.7+C, 立式, 0.8mm*2P*5.5TS, 加套管, L=60uH MIN, PIN长=10±2.0mm

日期：2019/3/21

版本：A

增益签核：

制订	审核	核准
夏琳		李万

客户签核：

工程	审核	核准



东莞市增益实业有限公司

地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号

电话：0769-87321000

传真：0769-87891229

物料类型：

共模电感

日期：

2019/3/21

版本：

A

图 面 规 格 变 更 履 历 表

PAGE: 1 of 4


客户		康泰医学	料号		品名	
客户版本	增益版本	变更内容	日期	制定	审核	核准
	A	初版	2019/3/21	张翔	刘业明	柯文学
	A1	脚距变更为大于0.7mm	2020/4/30	张翔	刘业明	柯文学
 东莞市增益实业有限公司 地址：东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话：0769-87321000 传真：0769-87891229				物料类型：	共模电感	
				日 期：	2019/3/21	
				版 本：	A1	

SPECIFICATION


PAGE: 2 of 4

1.DIMENSION (Unit:mm) & SCHEMATIC

1. 正视图

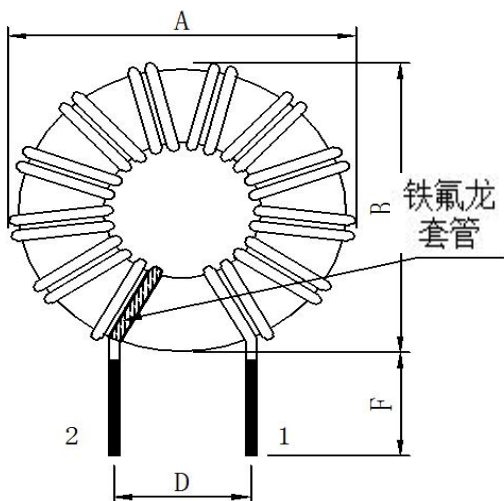


2. 侧视图

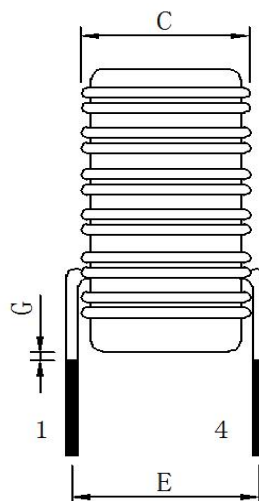

- 备注:**
- 1、 产品为双绕并绕
 - 2、 绕线须平整, 铜线无交叉、破皮现象
 - 3、 产品须含浸作业, 进出线需点黑胶固定
 - 4、 N2绕组出入线须套铁氟龙套管, 且伸入内环1/2处

DIM	A	B	C	D	E	F	G	
mm	18.0	18.0	11.0	大于0.7	6.5	10.0	1.0	/
SPEC	MAX	MAX	MAX	REF	REF	±2.0	MAX	

2.SCHEMATIC:(线路图)

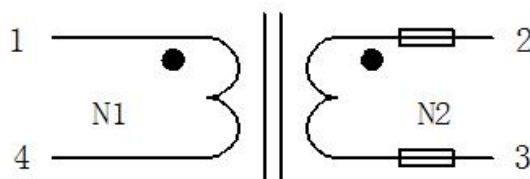

3. WINDING TABLE :(绕线结构)

STEP	绕组	起点	终点	材料	圈数	COLOR
1	N1	1	4	0.8mm*1P	5.5TS REF	本色
2	N2	2	3	0.8mm*1P	5.5TS REF	红色



东莞市增益实业有限公司
地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
电话: 0769-87321000
传真: 0769-87891229

物料类型:	共模电感
日期:	2019/3/21
版本:	A1

制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学
----	----	----	-----	----	-----

SPECIFICATION

PAGE: 3 of 4

4. ELECTRICAL CHARACTERISTIC: TEMPERATURE AT 25℃ HUMIDITY AT 65±5% RH

TEST ITEM (测试项目)	TEST CONDITION (测试条件)	TEST WINDING (测试绕组)	RESULT (条件范围)
电感 测试仪器: HP-4284A	1KHZ/1V	1-4、2-3	60uH MIN
Q值 测试仪器: HP-4284A	/		/
DCR (电阻) 测试仪器: HK-502BC	AT25℃	1-4、2-3	10.0mΩ MAX
HI-POT TEST (耐电压测试) 测试仪器: HY-7110		AC N1--N2	AC 500V 5mA 3S

5. MATARLAL LIST:

NO	ITEM	MTERIAL	MANUFACTURER	UL
1	磁芯	T12.7*7.92*4.7+C KA50 or EQUIVALENT	JIUXIN	
2	铜线	2UEW 130℃ or EQUIVALENT	PACIFIC	E201757
3	套管	铁氟龙 or EQUIVALENT	CHANGYUAN	
4	凡立水	DA-700-6 or EQUIVALENT	QIANGDA	E347463
5	黑胶	AB胶	QIANGDA	



东莞市增益实业有限公司
地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号
电话: 0769-87321000
传真: 0769-87891229

物料类型:	共模电感
日期:	2019/3/21
版本:	A1

制订	张翔	审核	刘业明	核准	柯文学
----	----	----	-----	----	-----

样品检测成绩表

PAGE: 4 of 4

客户名称:											
规格描述:		T12. 7*7. 92*4. 7+C, 立式, 0. 8mm*2P*5. 5TS, 加套管, L=60uH MIN, PIN长=10±2. 0mm									
交货数量	抽样数	抽样基准 MIL-STD-105E ■ 正常 □ 加严 □ 减严		判定标准		测试环境		分项检查判定			
5PCS	5PCS			主要	次要	温度	湿度	尺寸		外观	
			0. 1	0. 4	25℃	75%		OK		OK	OK
绝缘电阻DC	COIL TO CORE	V	COIL TO COIL	500V	测试仪器 ☐ CH-9053 ☒ HK-502BC						
		MΩ		MΩ	☒ HP-4284A ☐ CH-100 ☒ HY-7110						
耐电压AC		SEC		3SEC	☐ HP-42841A ☐ CH-1320 ☒ HK-310						
		KV		KV	☐ TF-6815 ☐ HK-1062 ☒ 卡尺						
测试条件	1KHZ/1V				外观尺寸 (mm)						
PIN	L (1-2)	L (4-3)	DCR (1-2)	DCR (4-3)	A	B	C				
SPEC	60uH	60uH	10m Ω	10m Ω	18. 0	18. 0	11. 0				
±	MIN	MIN	MAX	MAX	MAX	MAX	MAX				
1	81. 68	81. 68	4. 14	4. 14	15. 00	14. 14	6. 99				
2	86. 71	86. 71	4. 23	4. 23	14. 96	14. 23	6. 96				
3	85. 34	85. 34	4. 16	4. 16	14. 93	14. 19	7. 04				
4	80. 56	80. 56	4. 19	4. 19	15. 06	14. 14	6. 95				
5	81. 66	81. 66	4. 14	4. 14	14. 98	14. 16	6. 96				
6											
7											
8											
9											
10											
X											
R											
备 注:											
 东莞市增益实业有限公司 地址: 东莞市塘厦镇林村塘厦大道北552号 电话: 0769-87321000 传真: 0769-87891229					物料类型:		共模电感				
					日 期:		2019/3/21				
					版 本:		A1				
制订	张翔		审核		刘业明		核准		柯文学		